



Sistema Integrado de Gestão da Assistência à Saúde

Versão 44.1.0 – março de 2018

SIGA SAÚDE



Melhorias e correções



Melhorias e correções

Melhorias		
MÓDULO/ FUNCIONALIDADE	Título	Demanda
Programas / AMG	Atualização do layout do termo de responsabilidade do glicosímetro	120805

Correções de bugs		
MÓDULO/ FUNCIONALIDADE	Título	Demanda
CMES / Informações Básicas e SIGAPEP	Atualização do cadastro do estabelecimento desabilita operação do SIGAPEP	105718
Configuração / Agenda Regulada / Impedimentos	Impedimento de Estabelecimento não funciona para equipamento	107931

- Programas / AMG

Atualização do layout do termo de responsabilidade do glicosímetro

O termo de responsabilidade para retirada do aparelho foi atualizado, a pedido da área técnica, de acordo com as normas vigentes do programa.

O texto passa a considerar os dados da fabricante IQUEGO; o impresso apresenta nova área, relativa à autorização para compartilhamento dos dados, visando a geração de estatística e pesquisa científica pela referida instituição.

	Programa de Automonitoramento Glicêmico (AMG) TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA RETIRADA DE APARELHO GLICOSÍMETRO 21/02/2018 - 10:32
---	--

Estabelecimento: 2788527 AMA/UBS

CNES:

Eu, IVA VIEIRA GUIMARAES, portador(a) do CPF (Sem cpf) , do Cartão SUS de nº 801440478129659 e Prontuário nº NumeroProntuario() , endereço Rua NEA, número 260, CEP 03662000, fone 11 - 20234284, São Paulo, Capital, recebi da Unidade Básica de Saúde na data de 21/02/2018, 01 (um) aparelho glicosímetro da marca **IQUEGO GLUCOLEADER**, nº de série 5556565655, para controle e tratamento de Diabetes Mellitus.

Em virtude do cumprimento da resolução CIT nº 007/2016 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de dados no Prontuário Eletrônico; da necessidade de atender à rastreabilidade do produto, conforme a RDC 16/2013 da ANVISA, itens 6.3 e 6.4; visando a melhoria do controle do uso do produto pelo consumidor final e compartilhamento de dados com órgãos públicos, médicos e com os próprios pacientes, o software GLICOSYS foi desenvolvido pela empresa HMD Brasil para esta prefeitura, servindo como uma interface auxiliar na coleta de dados de medição dos pacientes para o compartilhamento com a plataforma e-SUS.

Estou ciente de minha inteira responsabilidade na guarda e conservação do aparelho a mim cedido. Do mesmo modo, também estou ciente que este aparelho destina-se a meu

Uma vez aprovado pelo Comitê de Ética, a informação coletada também poderá ser utilizada pela IQUEGO/HMD para a realização de estatísticas e pesquisas científicas retrospectivas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem (Lei 12.527/2011, Art. 31, §3º, II).

Autorizo o compartilhamento para pesquisa Não autorizo o compartilhamento para pesquisa

Assinatura do paciente ou de seu responsável

OBSERVAÇÕES:

ATENÇÃO: Preencher em 3 vias - uma para a Unidade, outra para o paciente, outra para o fabricante. A via da unidade deve ficar no Prontuário.


- CMES / Informações Básicas e SIGAPEP

Atualização do cadastro do estabelecimento desabilita operação do SIGAPEP

Nessa versão, foi alterado o comportamento do módulo Cadastro / Estabelecimentos e Profissionais, referente a utilização da tela "Informações Básicas".

Ao navegar pelas abas da tela, para atualizar algum dado, por exemplo, o sistema automaticamente desabilitava a operação do SIGAPEP, fazendo com que os novos pacientes recepcionados para atendimento não fossem carregados nos painéis dos setores.

A funcionalidade foi ajustada e a utilização desta não mais desabilita a operação do prontuário eletrônico do SIGA.

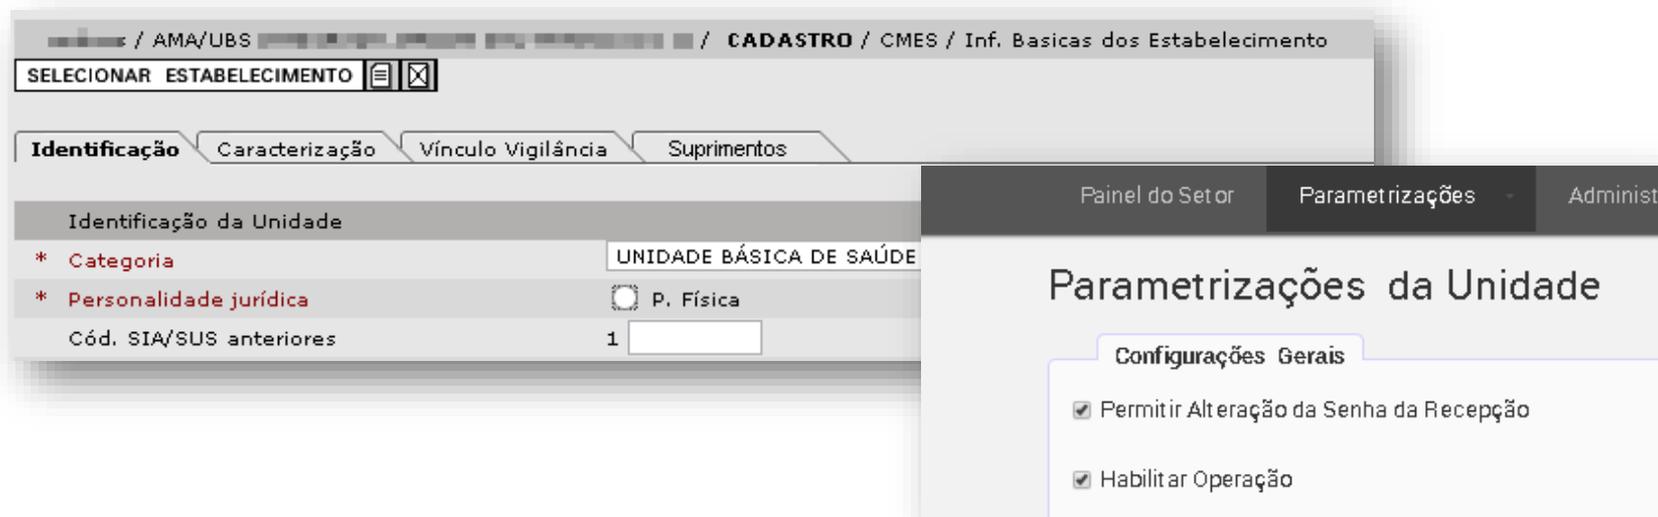

The screenshot displays the 'CADASTRO / CMES / Inf. Basicas dos Estabelecimento' interface. The main window has tabs for 'Identificação', 'Caracterização', 'Vínculo Vigilância', and 'Suprimentos'. The 'Identificação' tab is active, showing fields for 'Categoria' (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), 'Personalidade jurídica' (radio buttons for 'P. Física'), and 'Cód. SIA/SUS anteriores' (1). A 'Parametrizações da Unidade' dialog box is overlaid on top, with tabs for 'Painel do Setor', 'Parametrizações', and 'Administ'. The 'Parametrizações' tab is selected, showing 'Configurações Gerais' with two checked options: 'Permitir Alteração da Senha da Recepção' and 'Habilitar Operação'.

- Configuração / Agenda Regulada / Impedimentos

Impedimento de Estabelecimento não funciona para equipamento

A partir dessa versão, o impedimento configurado para todo o estabelecimento passa, também, a cancelar as vagas das agendas de equipamento na Agenda Regulada.

Deixa de ser necessário configurar os impedimentos para cada equipamento que possua agenda, quando a instituição/unidade não oferta vagas em determinado período ou dia (por exemplo: emendas de feriado).